Contour next link
Système d'autosurveillance glycémique par radio fréquence RF
CODAGE AUTOMATIQUE
Utilisation uniquement avec les bandelettes réactives CONTOUR®NEXT de Bayer
Medtronic
MANUEL D'UTILISATION SIMPLIFIÉ

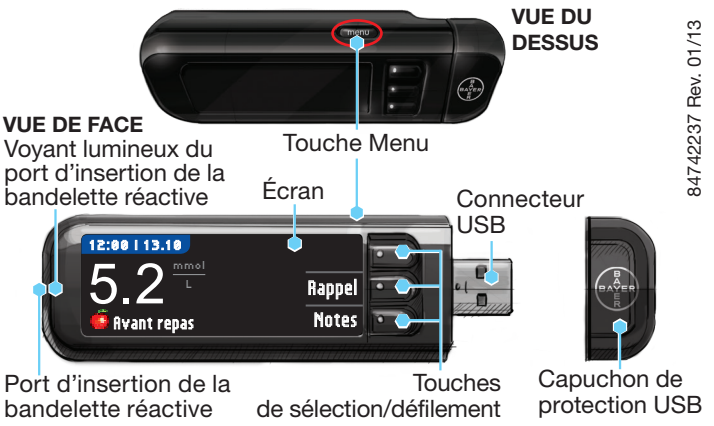

84742237 Rev. 01/13

Remarque : Vérifier les unités de mesure du lecteur de glycémie. Pour plus d'informations, consulter le Manuel d'utilisation.

Configuration initiale du lecteur de glycémie et connexion à l'appareil Medtronic compatible

Chargement du lecteur de glycémie

1 **Enlever le capuchon de protection USB pour faire apparaître le connecteur USB.**
Le lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT LINK de Bayer fonctionne avec une batterie rechargeable.
Charger le lecteur de glycémie avec le chargeur mural* ou en branchant le connecteur USB à un ordinateur. S'assurer que l'ordinateur est allumé.
Le lecteur de glycémie affiche brièvement à l'écran « Ne pas se tester – En charge » et le port d'insertion de la bandelette réactive clignote. **Ne pas réaliser de test de glycémie pendant que le lecteur de glycémie est en charge.**
Lorsque la batterie est rechargée, le voyant lumineux du port d'insertion de la bandelette réactive s'éteint. Déconnecter le lecteur de glycémie CONTOUR NEXT LINK pour réaliser un test de glycémie.

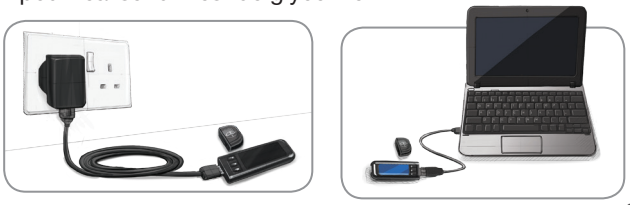

Déconnecter le lecteur de glycémie de la source de charge avant de commencer la configuration

2 Pour commencer la configuration, maintenir enfoncée la touche Menu pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que le lecteur de glycémie s'allume.

3 Faire défiler vers le bas pour sélectionner la langue souhaitée et appuyer sur **OK**.

Appuyer sur **OK** si la langue en surbrillance est celle souhaitée.
Appuyer sur **NON** si la langue affichée n'est pas la langue souhaitée.

4 Appuyer sur **OK** pour lancer le processus de connexion.
REMARQUE : La pompe fait référence à l'appareil Medtronic compatible.

5 **STOP. N'APPUYER sur AUCUNE touche.**
L'écran affiche le numéro d'identification du lecteur de glycémie (dans le coin inférieur gauche). Cet identifiant est nécessaire pour terminer le processus de connexion.
Poser le lecteur de glycémie. Prendre l'appareil Medtronic compatible et passer à l'Étape 6.

Connecter le lecteur de glycémie à la pompe à insuline MiniMed® Paradigm®

6 Appuyer sur **ACT** pour aller à **MENU PRINCIPAL**. Faire défiler jusqu'à **Fonctions** à l'aide de la touche bas. Appuyer sur **ACT**.

7 Faire défiler jusqu'à **Connecter appareils** et appuyer sur **ACT**. Faire ensuite défiler jusqu'à **Lecteurs** et appuyer sur **ACT**.
Remarque : si le **MENU FONCTIONS** ne contient pas **Connecter appareils**, faire défiler jusqu'à **Options Lecteur** et appuyer sur **ACT**.

8 Sélectionner **Oui** et appuyer sur **ACT**. Pour **changer** de lecteur de glycémie, aller à l'**Étape 9**. Pour **ajouter** un nouveau lecteur de glycémie, aller à l'**Étape 11**.

9 Pour remplacer un lecteur de glycémie, sélectionner **Effacer No. ID** et appuyer sur **ACT**.



10 Si vous possédez plusieurs identifiants de lecteur de glycémie, répéter l'Étape 9 pour chacun d'entre eux.

? = Aide

*Si le chargeur n'est pas disponible dans le conditionnement du système d'autosurveillance glycémique, contacter le Service Clientèle de Bayer. Les coordonnées du Service Clientèle de Bayer sont disponibles à la page suivante.

11 Pour ajouter un nouveau lecteur, sélectionner **Ajouter No. ID** et appuyer sur **ACT**. Se reporter à l'Étape 5 (ou voir au dos du lecteur de glycémie) pour trouver l'identifiant du lecteur de glycémie.
Utiliser les touches de défilement haut et bas pour saisir les six caractères de l'identifiant du lecteur (SN) visibles sur l'écran.
Appuyer sur **ACT** après avoir saisi chaque caractère.



12 Sélectionner **Revoir No. ID** sur l'appareil Medtronic compatible pour vérifier que l'identifiant du lecteur CONTOUR®NEXT LINK a été saisi correctement. Sinon, revenir à l'Étape 9.
REMARQUE : Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation de l'appareil Medtronic compatible.



13 Revenir au lecteur de glycémie CONTOUR NEXT LINK. Après avoir saisi l'identifiant du lecteur de glycémie dans l'appareil Medtronic compatible, appuyer sur **Suivant**.



Choix des Options d'envoi du lecteur de glycémie

14 **OPTIONS D'ENVOI** contrôle la façon dont le lecteur de glycémie enverra les résultats glycémiques à l'appareil Medtronic compatible.
Choisir l'**OPTION D'ENVOI** souhaitée.
Toujours = le lecteur de glycémie enverra toujours les résultats.
Demander = le lecteur de glycémie posera la question avant d'envoyer les résultats.
Jamais = le lecteur n'enverra jamais les résultats.

Régler la date et l'heure du lecteur de glycémie pour qu'elles correspondent avec celles de l'appareil Medtronic

15 La date et l'heure du **lecteur** doivent correspondre à la date et à l'heure de l'**appareil Medtronic**. Prendre **l'appareil Medtronic**.
Appuyer sur **ACT** pour aller à **MENU PRINCIPAL**.
Faire défiler jusqu'à **Fonctions** et appuyer sur **ACT**.
Faire défiler jusqu'à **Heure/Date** et appuyer sur la touche **ACT**. Sélectionner le format de l'heure et appuyer sur **ACT**. Entrer l'heure et la date.
Revenir au **lecteur**. Suivre les instructions du **lecteur de glycémie** pour que l'heure et la date correspondent à celles de l'**appareil Medtronic**.

Autres paramètres du lecteur de glycémie

16 Appuyer sur **Accepter** pour sélectionner **AutoLog désactivé**.
AutoLog permet de marquer un résultat de test comme À jeun, Avant repas, Après repas ou Aucun marqueur.
Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation.

17 **Accepter** ou **Modifier** les Alertes haute et basse.
Le lecteur de glycémie vous alerte d'un signal sonore lorsque le niveau de glycémie est supérieur ou inférieur à vos niveaux préconfigurés.

18 **Accepter** ou **Modifier** l'intervalle Cible.
L'intervalle Cible est l'objectif défini pour les résultats glycémiques.



REMARQUE : Les Alertes ne peuvent être configurées qu'en dehors de votre ou de vos intervalles Cibles. Les Cibles peuvent être configurées dans l'intervalle défini par les valeurs des Alertes. Pour plus d'informations, contacter le Service Clientèle. Les coordonnées du Service Clientèle de Bayer sont disponibles à la page suivante.

LA CONFIGURATION EST MAINTENANT TERMINÉE.

Voir au dos pour consulter les instructions relatives au test de glycémie. ➡

84742237 Rev. 01/13

Matériel nécessaire pour la réalisation du test de glycémie

Bandelette réactive CONTOUR®NEXT de Bayer



Autopiqueur MICROLET®2 de Bayer



Lancette MICROLET® de Bayer

Lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT LINK de Bayer

⚠ AVERTISSEMENT :

- L'autopiqueur MICROLET®2 est conçu pour l'autosurveillance d'un seul patient. Il ne doit pas être utilisé par plus d'une personne afin d'éviter tout risque de contamination.[1,2]
- Utiliser une nouvelle lancette MICROLET® à chaque nouveau test. L'usage unique garantit les conditions de stérilité de la lancette.
- Toutes les pièces de ce conditionnement sont considérées comme biologiquement dangereuses et peuvent potentiellement transmettre des maladies infectieuses, même après nettoyage.
- Bien se laver les mains à l'eau savonneuse avant et après un test de glycémie, la manipulation du lecteur de glycémie, de l'autopiqueur ou des bandelettes réactives.

Pour plus d'informations sur l'entretien du lecteur de glycémie, consulter le manuel d'utilisation.

Réalisation d'un test de glycémie

Prélèvement sanguin

1 À partir de n'importe quel écran, insérer la bandelette réactive et attendre l'apparition du message **APPLIQUER LE SANG**.

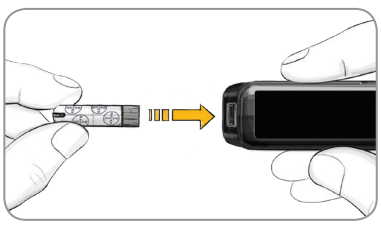

2 Retirer l'embase de l'autopiqueur. Insérer la lancette dans l'autopiqueur et enlever le capuchon de protection de la lancette.

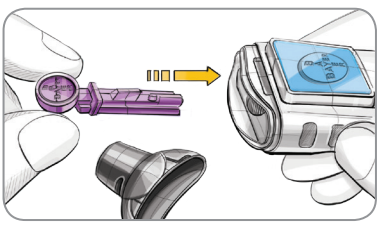

3 Replacer l'embase réglable sur l'autopiqueur et régler la molette pour obtenir la profondeur de prélèvement souhaitée.

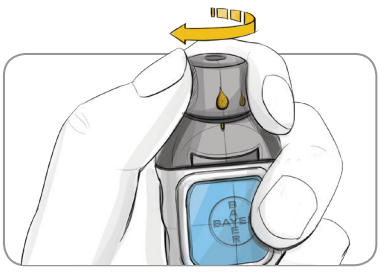

4 Prélèvement sanguin.

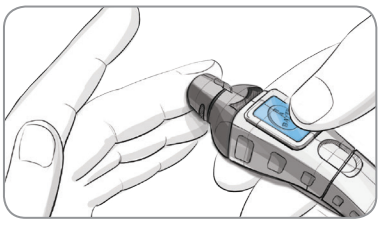

Réalisation du test de glycémie

5 Mettre immédiatement l'extrémité de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang. Si la goutte de sang n'est pas suffisante, le lecteur de glycémie émet deux signaux sonores et affiche à l'écran **QUANTITÉ SANG INSUFFISANTE**. Vous avez environ 30 secondes pour appliquer davantage de sang sur la même bandelette réactive.

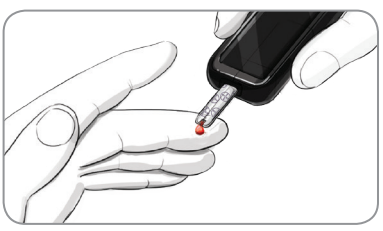

6 Si AUTOLOG est activé, enregistrer le résultat comme : **À jeun**, **Avant repas**, **Après repas** ou **Aucun marqueur** pour le résultat glycémique.

REMARQUE : Si le résultat glycémique est supérieur à la limite de l'Alerte haute ou inférieur à la limite de l'Alerte basse, il s'affiche automatiquement sans avoir à faire préalablement une sélection AutoLog.

Références

1 FDA Public Health Notification: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication (2010). http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm

2 CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens (2010). http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html

Envoi des résultats à l'appareil Medtronic compatible

7 Si **Toujours** a été sélectionné dans **Options d'envoi** au moment de la **Configuration**, les résultats seront envoyés directement à la pompe. Si **Demander** a été sélectionné dans **Options d'envoi** au moment de la **Configuration**, il est possible de choisir d'envoyer ou non le résultat à la pompe après chaque test de glycémie.
Appuyer sur **Envoi: Oui** ou **Envoi: Non**.

Appuyer sur **OK** pour passer à l'écran suivant.

MISE EN GARDE : Vérifier systématiquement que le résultat glycémique affiché sur la pompe correspond à celui affiché sur le lecteur de glycémie.

Rappel et Remarques

8 Sélectionner **Rappel** pour programmer un rappel pour le prochain test de glycémie. Sélectionner **Notes** pour ajouter des informations au résultat. Retirer la bandelette réactive.

Éteindre le lecteur de glycémie

9 Retirer la bandelette réactive et le lecteur de glycémie s'éteint après 3 minutes. Ou maintenir enfoncée la touche Menu pour éteindre le lecteur de glycémie.

Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation CONTOUR®NEXT LINK, la notice de l'autopiqueur MICROLET®2 et le manuel d'utilisation de l'appareil Medtronic compatible.

Le Service Clientèle de Bayer est disponible par Hotline: 044 465 83 55.

E-mail: info@bayerdiabetes.ch
Internet: www.bayerdiabetes.ch

IVD Pour un usage de diagnostic in vitro

Bayer HealthCare

Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland

CE 0088

Medtronic

Bayer, la Croix Bayer, CONTOUR, MICROLET et le logo Codage Automatique sont des marques déposées de Bayer. L'ensemble des autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Bayer

© 2013 Bayer. Tous droits réservés.